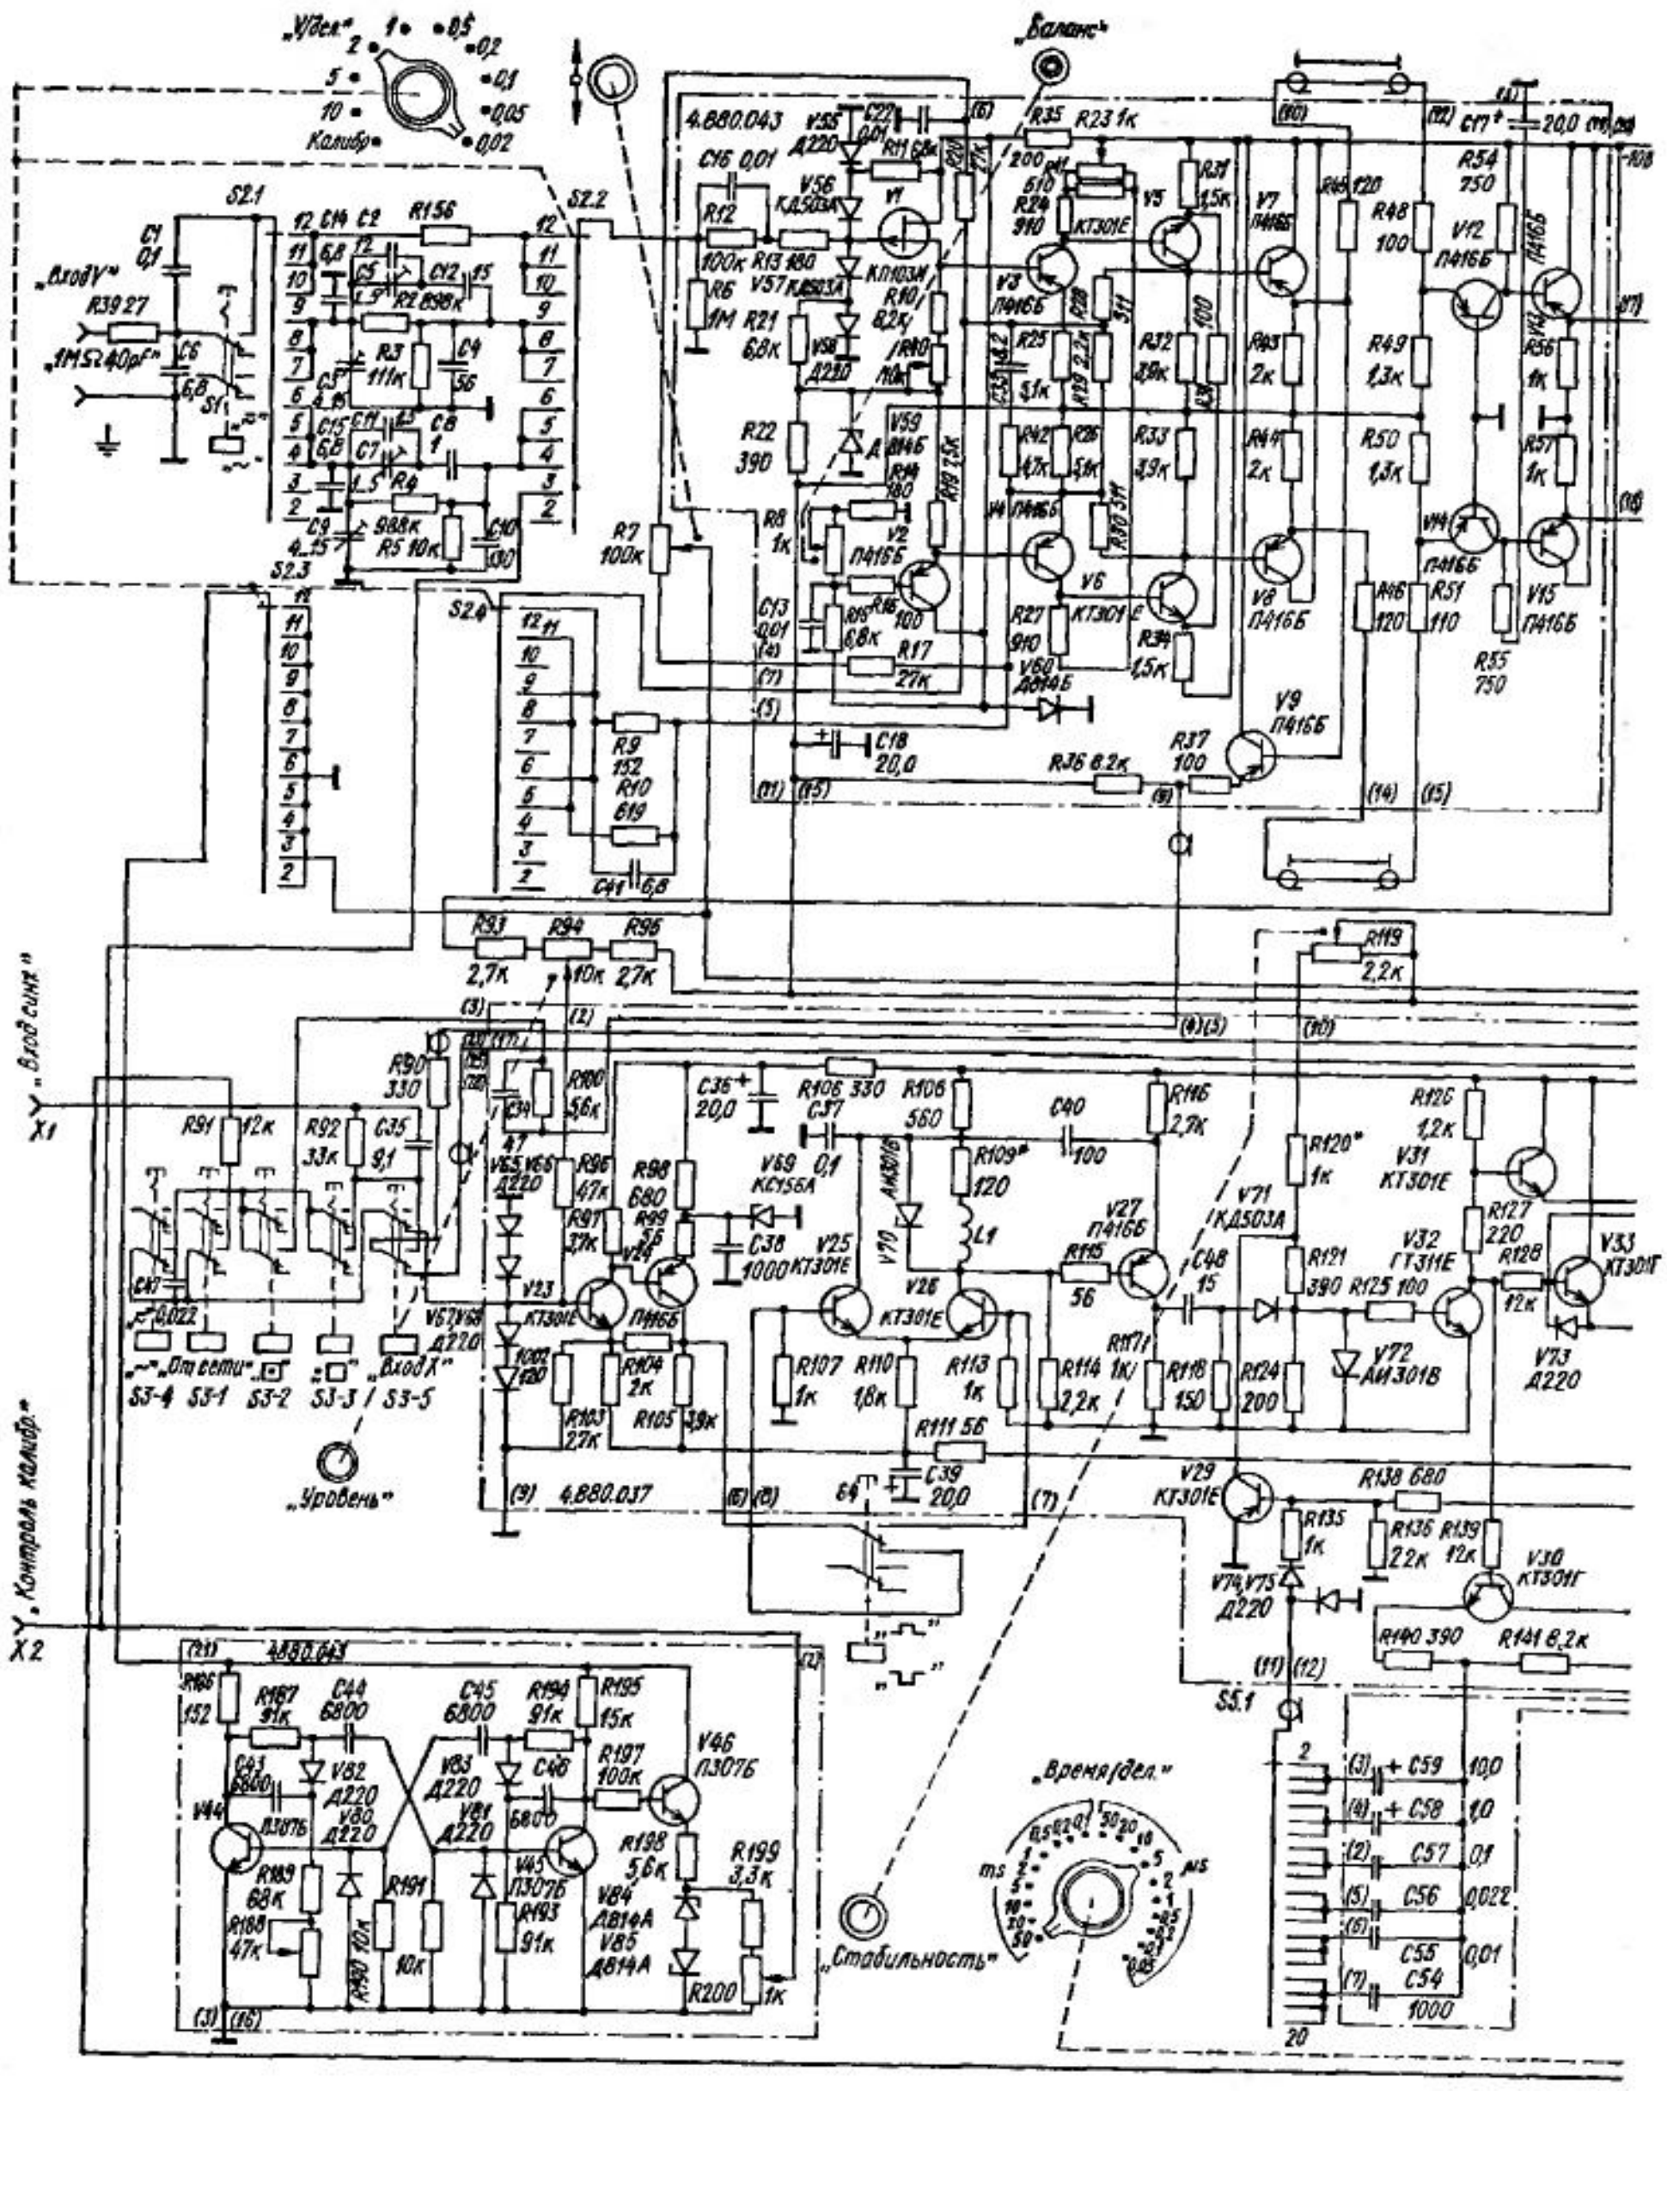
„V/дел"
Калибр
„Вход V"
„Баланс"
4.880.043
„Вход синх"
X1
„Отсети"
„Вход X"
S3-4
S3-1
S3-2
S3-3
S3-5
„Уровень"
4.880.037
„Контроль калибр."
X2
4.880.043
„Время/дел."
ms
µs
„Стабильность"
S5.1
КТ301Е
П416Б
КП103И
КД503А
Д220
Д814Б
КС156А
АЛ301Б
ГТ311Е
КТ301Г
П307Б
Д814А

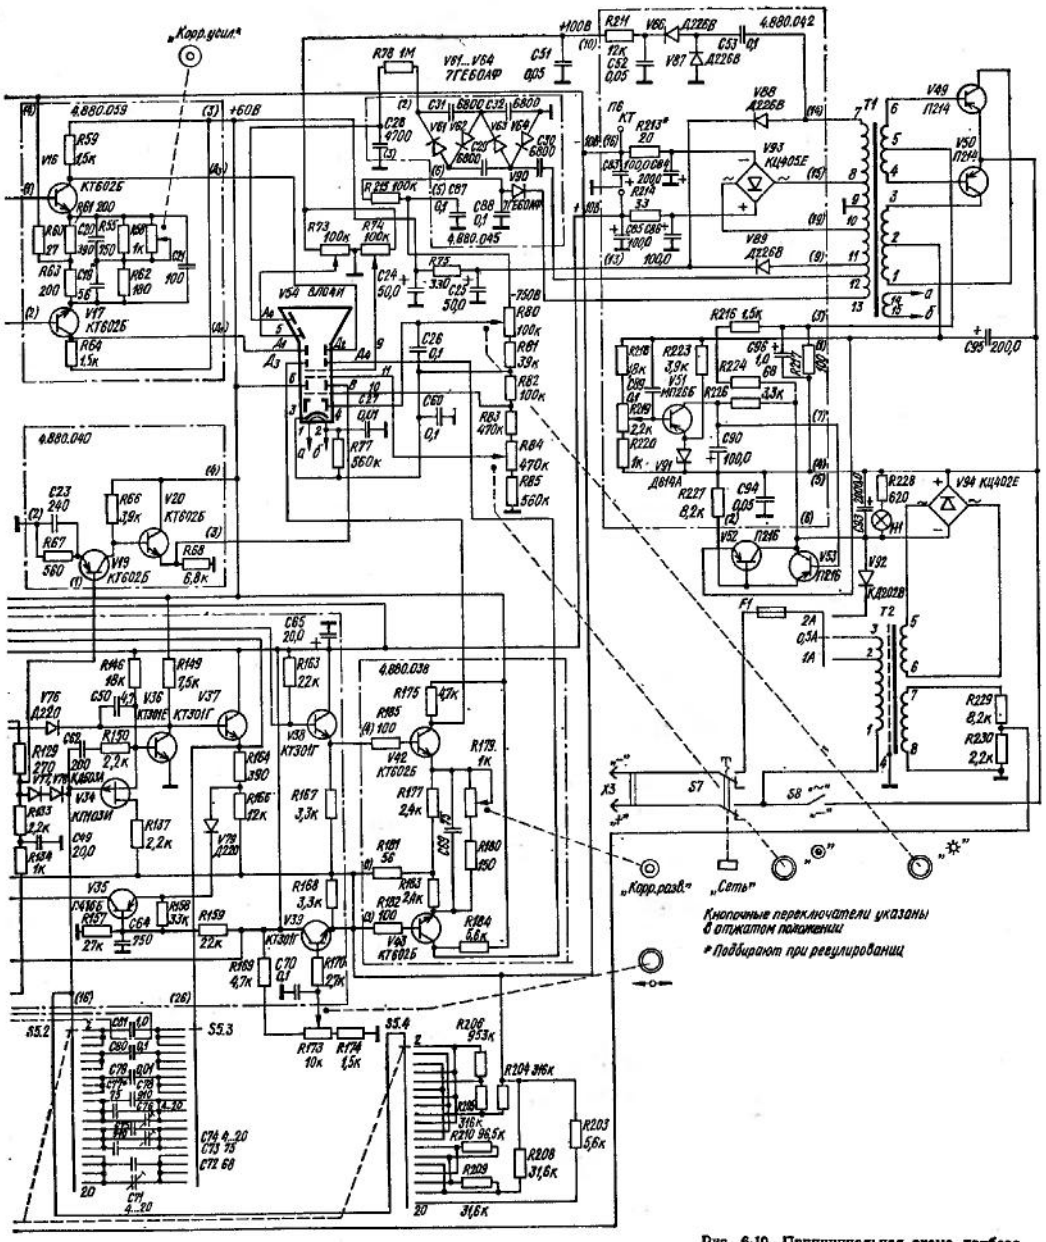

Рис. 6-10. Принципиальная схема прибора С1-72